



# bioavid – Testdurchführung

## BLH- und BL-Serie

### 1 Probenvorbereitung

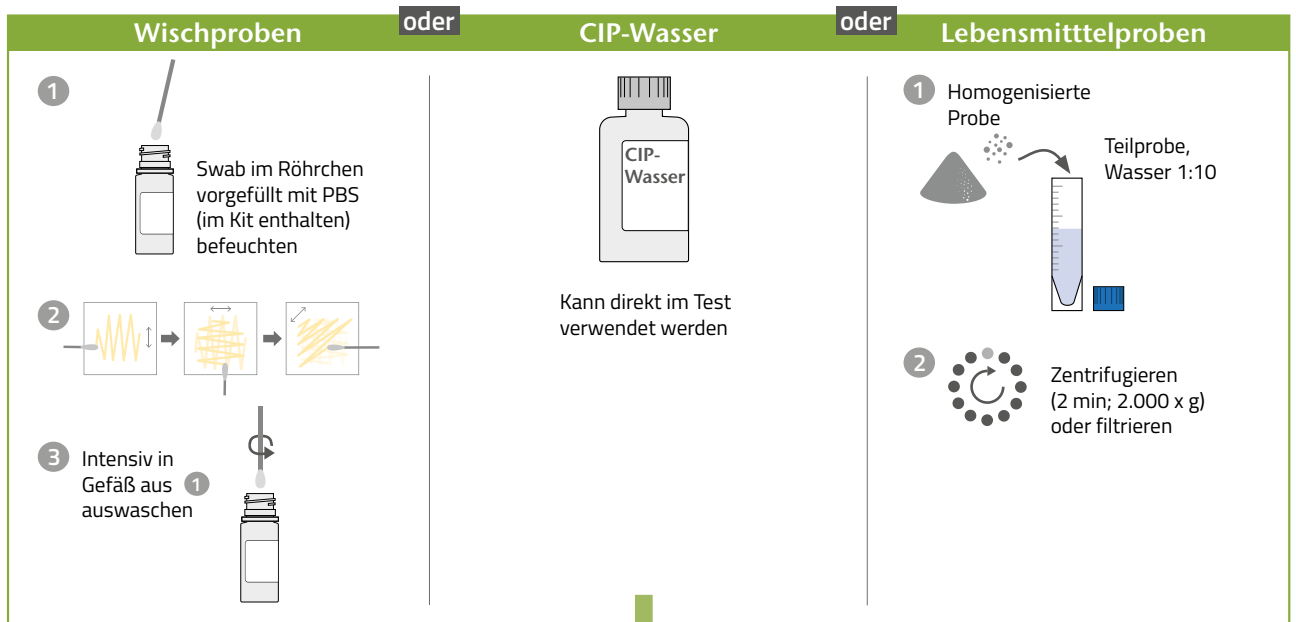

### 2 Testdurchführung

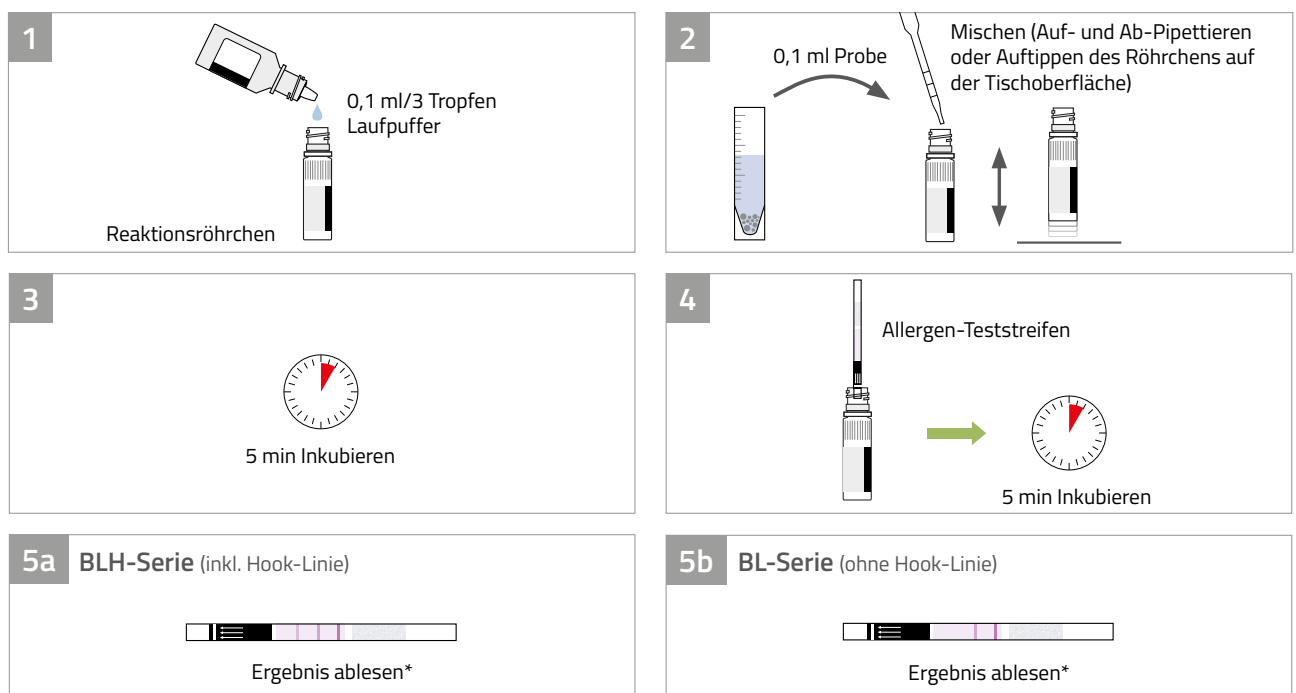

\* Die Interpretation der Ergebnisse entnehmen Sie bitte der jeweiligen Auswertekarte für die BLH- oder BL-Serie.